

令和元年度
浜岡原子力発電所
UPZ 圏内（10km 以遠）
環境放射能測定結果報告書
（中間報告）

令和元年 10 月 30 日

静岡県環境放射線監視センター

（実施期間：平成 31 年 4 月～令和元年 9 月）

目 次

ページ

1	測定計画	1
2	測定方法	1
3	測定のまとめ	1
4	測定結果		
	(1) 空間放射線量の測定結果		
	ア 空間ガンマ線測定装置による線量率（連続測定）	2
	イ 蛍光ガラス線量計による積算線量（3ヶ月間）	13
	(2) 環境試料中の放射能の測定結果		
	機器分析によるガンマ線放出核種の放射能	14
	【参 考】		
	測定器の種類	16
	UPZ 圏内（10km 以遠）空間線量測定地点及び環境試料採取地点図		17

1 測定計画

(1) 空間放射線量の測定

ア 空間ガンマ線測定装置による線量率（連続測定）
12 地点（うち協定に基づく測定の計画数 6 地点）

イ 蛍光ガラス線量計による積算線量（3 ヶ月間）
22 地点（うち協定に基づく測定の計画数 10 地点）

(2) 環境試料中の放射能の測定

機器分析によるガンマ線放出核種の放射能
25 地点（うち協定に基づく測定の計画数 22 地点）

2 測定方法

16 ページに記載の測定器により、静岡県環境放射能測定技術会が定める「環境放射能測定法」に準じて実施した。

3 測定のまとめ

令和元年9月末までの測定結果は次頁以降に示すとおりである。

測定結果は、浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果と同程度であり、特異な傾向は認められなかった。

4 測定結果

(1) 空間放射線量の測定

ア 空間ガンマ線測定装置による線量率（連続測定）

① 1時間平均値及び3ヶ月間平均値

単位：nGy/h

測定地点名 ¹⁾	月	1時間平均値		3ヶ月間平均値	
		最小値	最大値		
<u>磐田市 福田支所</u>	4月	35	58	37	
	5月	35	52		
	6月	34	59		
	7月	34	55	36	
		8月	33		42
		9月	34		42
		10月			
		11月			
		12月			
	<u>袋井市 袋井市役所</u>	4月	41	64	44
		5月	41	59	
		6月	41	62	
7月		40	61	43	
		8月	41		52
		9月	42		53
		10月			
		11月			
		12月			
<u>森町 飯田総合センター</u>		4月	37	69	39
		5月	37	52	
		6月	36	61	
	7月	36	55	39	
		8月	37		49
		9月	37		44
		10月			
		11月			
		12月			
	<u>掛川市 掛川市役所</u>	4月	42	68	45
		5月	42	59	
		6月	41	62	
7月		41	62	44	
		8月	42		51
		9月	43		53
		10月			
		11月			
		12月			
1月					
		2月			
		3月			

注1) 下線は協定に基づく測定の実施地点

単位：nGy/h

測定地点名	月	1 時間平均値		3 ヶ月間平均値	
		最小値	最大値		
掛川市 大須賀支所	4 月	39	60	42	
	5 月	39	57		
	6 月	39	59		
	41	7 月	38	56	
		8 月	39	48	
		9 月	40	46	
		10 月			
		11 月			
		12 月			
	掛川市 倉真	4 月	41	69	43
		5 月	41	57	
		6 月	40	58	
43		7 月	40	59	
		8 月	41	50	
		9 月	41	52	
		10 月			
		11 月			
		12 月			
菊川市 菊川市役所		4 月	45	65	47
		5 月	44	60	
		6 月	44	63	
	46	7 月	44	63	
		8 月	44	51	
		9 月	44	51	
		10 月			
		11 月			
		12 月			
	牧之原市 富士山静岡空港	4 月	40	72	44
		5 月	41	60	
		6 月	40	71	
43		7 月	41	65	
		8 月	41	52	
		9 月	41	50	
		10 月			
		11 月			
		12 月			
		1 月			
		2 月			
		3 月			

単位：nGy/h









測定地点名 ¹⁾	月	1時間平均値		3ヶ月間平均値	
		最小値	最大値		
<u>島田市 中央公園</u>	4月	41	67	43	
	5月	41	65		
	6月	40	63		
	42	7月	37	61	
		8月	39	65	
		9月	38	49	
		10月			
		11月			
		12月			
	牧之原市 萩間小学校	1月			45
		2月			
		3月			
44		4月	41	66	
		5月	42	57	
		6月	41	67	
		7月	39	61	
		8月	40	50	
		9月	41	49	
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					
<u>吉田町 吉田町役場</u>	4月	46	72	48	
	5月	46	65		
	6月	44	71		
	47	7月	45	65	
		8月	45	55	
		9月	46	63	
		10月			
		11月			
		12月			
	1月				
	2月				
	3月				
<u>焼津市 大井川庁舎北</u>	4月	44	70	46	
	5月	43	63		
	6月	44	65		
	45	7月	43	59	
		8月	43	57	
		9月	43	56	
		10月			
		11月			
		12月			
	1月				
	2月				
	3月				
参 考 ²⁾ (R1 10km 圏内測定値の範囲)		36~75	38~57		

注 1) 下線は協定に基づく測定の実施地点





注 2) 令和元年度の県及び中部電力の 10km 圏内測定結果

② モニタリングポストの線量率（1ヶ月平均値）の推移

単位 nGy/h





単位：nGy/h





③ 線量率と降雨量の時系列グラフ

(注) 降雨が無い場合に線量率の上昇が見られているものは特に断りのない限り「感雨」が観測されている。



磐田市福田支所





袋井市役所



森町飯田総合センター





掛川市役所





※上線は線量率、下線は降雨量

掛川市大須賀支所





掛川市倉真





※上線は線量率、下線は降雨量

菊川市役所





牧之原市 富士山静岡空港





※上線は線量率、下線は降雨量

島田市中央公園





牧之原市萩間小学校





※上線は線量率、下線は降雨量

吉田町役場



焼津市大井川庁舎北



※上線は線量率、下線は降雨量

イ 蛍光ガラス線量計による積算線量（3ヶ月間）

単位：mGy

ポイント番号	測定地点		測定値（90日換算値）			
	地点名 ¹⁾		平成31年 3月19日～ 令和元年 6月18日	令和元年 6月19日～ 9月18日	（第3四半期）	（第4四半期）
101	<u>磐田市</u>	<u>大中瀬</u>	0.13	0.12		
102		<u>大原</u>	0.13	0.13		
103	<u>袋井市</u>	<u>上山梨</u>	0.13	0.13		
104		<u>浅名</u>	0.13	0.13		
105	<u>掛川市</u>	<u>富部</u>	0.13	0.13		
106		<u>大淵</u>	0.13	0.13		
107		<u>上西郷</u>	0.14	0.14		
108		<u>金城</u>	0.14	0.14		
109		<u>下土方</u>	0.15	0.15		
110		<u>大坂</u>	0.14	0.14		
111		<u>八坂</u>	0.15	0.15		
112	<u>菊川市</u>	<u>東横地</u>	0.16	0.16		
113		<u>倉沢</u>	0.14	0.14		
114	<u>島田市</u>	<u>金谷代官町</u>	0.17	0.17		
115		<u>中央町</u>	0.14	0.15		
116	<u>牧之原市</u>	<u>東萩間</u>	0.14	0.14		
117		<u>坂部</u>	0.15	0.15		
118		<u>静波</u>	0.15	0.15		
119	<u>藤枝市</u>	<u>岡出山</u>	0.14	0.15		
120	<u>吉田町</u>	<u>川尻</u>	0.14	0.14		
121	<u>焼津市</u>	<u>道原</u>	0.14	0.14		
122		<u>田尻北</u>	0.14	0.14		
参 考 ²⁾ (R1 10km 圏内測定値の範囲)			0.13～0.17			

注 1) 下線は協定に基づく測定の実施地点

注 2) 令和元年度の県及び中部電力の10km 圏内測定結果

(2) 環境試料中の放射能の測定結果

ガンマ線放出核種の放射能

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名 ¹⁾	採取年月日	⁵⁴ Mn, ⁵⁹ Fe, ⁶⁰ Co, ⁹⁵ Zr, ⁹⁵ Nb, ¹⁴⁴ Ce, ¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K ³⁾	参 考 ⁴⁾ (R1 10km 圏内測定結果)
玄 米	磐田市 福 田						(昨年度実績) ○測定地点 御前崎市下朝比奈 牧之原市地頭方 ○測定値の範囲 ¹³⁴ Cs: * ¹³⁷ Cs: *
	袋井市 川 会						
	森 町 中 川						
	掛川市 中	R1 年 8 月 26 日	* ²⁾	*	*	78	
	島田市 相 賀	R1 年 9 月 17 日	*	*	*	70	
	藤枝市 善左衛門	R1 年 9 月 7 日	*	*	*	73	
	吉田町 川 尻	R1 年 9 月 30 日	*	*	*	82	
	吉田町 住 吉	R1 年 9 月 30 日	*	*	*	79	
焼津市 利右衛門	R1 年 9 月 7 日	*	*	*	81		
とうもろこし	森 町 中 川	R1 年 6 月 4 日	*	*	*	96	
レタス	掛川市 小 貫						
かんしょ	磐田市 向 笠						
梨	焼津市 田 尻	R1 年 8 月 8 日	*	*	*	44.9	
柿	森 町 飯 田						

注 1) 下線は協定に基づく測定の実施地点

注 2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

注 3) ⁴⁰K は、自然放射性核種である。

注 4) 令和元年度の県及び中部電力の 10km 圏内測定結果

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名 ¹⁾	採取年月日	⁵⁴ Mn, ⁵⁹ Fe, ⁶⁰ Co, ⁹⁵ Zr, ⁹⁵ Nb, ¹⁴⁴ Ce, ¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K ³⁾	参考 ⁴⁾ (R1 10km 圏内測定結果)
茶 葉	<u>磐田市</u> 大久保	R1 年 5 月 5 日	*	*	*	147	○測定地点 御前崎市法ノ沢 御前崎市新谷 牧之原市笠名 菊川市川上 ○測定値の範囲 ¹³⁴ Cs: * ¹³⁷ Cs: 0.087~0.18
	<u>袋井市</u> 山崎	H31 年 4 月 26 日	*	*	*	122	
	<u>森町</u> 睦美	R1 年 5 月 8 日	*	*	0.11	159	
	<u>掛川市</u> 東山	R1 年 5 月 7 日	*	*	*	142	
	<u>島田市</u> 湯日	H31 年 4 月 26 日	*	*	*	147	
	<u>島田市</u> 大草	H31 年 4 月 26 日	*	*	*	166	
	<u>藤枝市</u> 谷稲葉	R1 年 5 月 10 日	*	*	0.16	151	
大豆	<u>袋井市</u> 中新田						
しろねぎ	<u>磐田市</u> 西平松						
しらす	<u>吉田町</u> <u>吉田港</u>	R1 年 9 月 4 日	*	*	*	77	○測定地点 御前埼灯台 御前崎港 ○測定値の範囲 ¹³⁴ Cs: * ¹³⁷ Cs: *~0.065
さくらえび	<u>焼津市</u> <u>大井川港</u>	R1 年 5 月 24 日	*	*	0.11	118	

注 1) 下線は協定に基づく測定の実施地点

注 2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

注 3) ⁴⁰K は、自然放射性核種である。


注 4) 令和元年度の県及び中部電力の 10km 圏内測定結果

【参 考】

測定器の種類

測定項目		測 定 器	校正年月
空間放射線量	線量率	NaI (Tl) 型空間ガンマ線測定装置 (株)日立製作所製エネルギー特性補償型	R1 年 7～9 月
	積算線量	蛍光ガラス線量計素子：AGC テクノグラス(株)製 SC-1 蛍光ガラス線量計読取装置：AGC テクノグラス(株)製 FGD251	R1 年 8, 9 月
環境試料中の放射能	核種分析 ガンマ線放出核種	波高分析装置 (検出器/波高分析器) キャンベラ製 GC4519/キャンベラ製 Lynx ユリシス製 GCW3523/キャンベラ製 Lynx キャンベラ製 GC4019/キャンベラ製 DSA-2000 キャンベラ製 GX4018/キャンベラ製 DSA-1000 キャンベラ製 GC4018/キャンベラ製 DSA-1000	R1 年 9 月

UPZ圏内（10km以遠）空間線量測定地点及び環境試料採取地点図

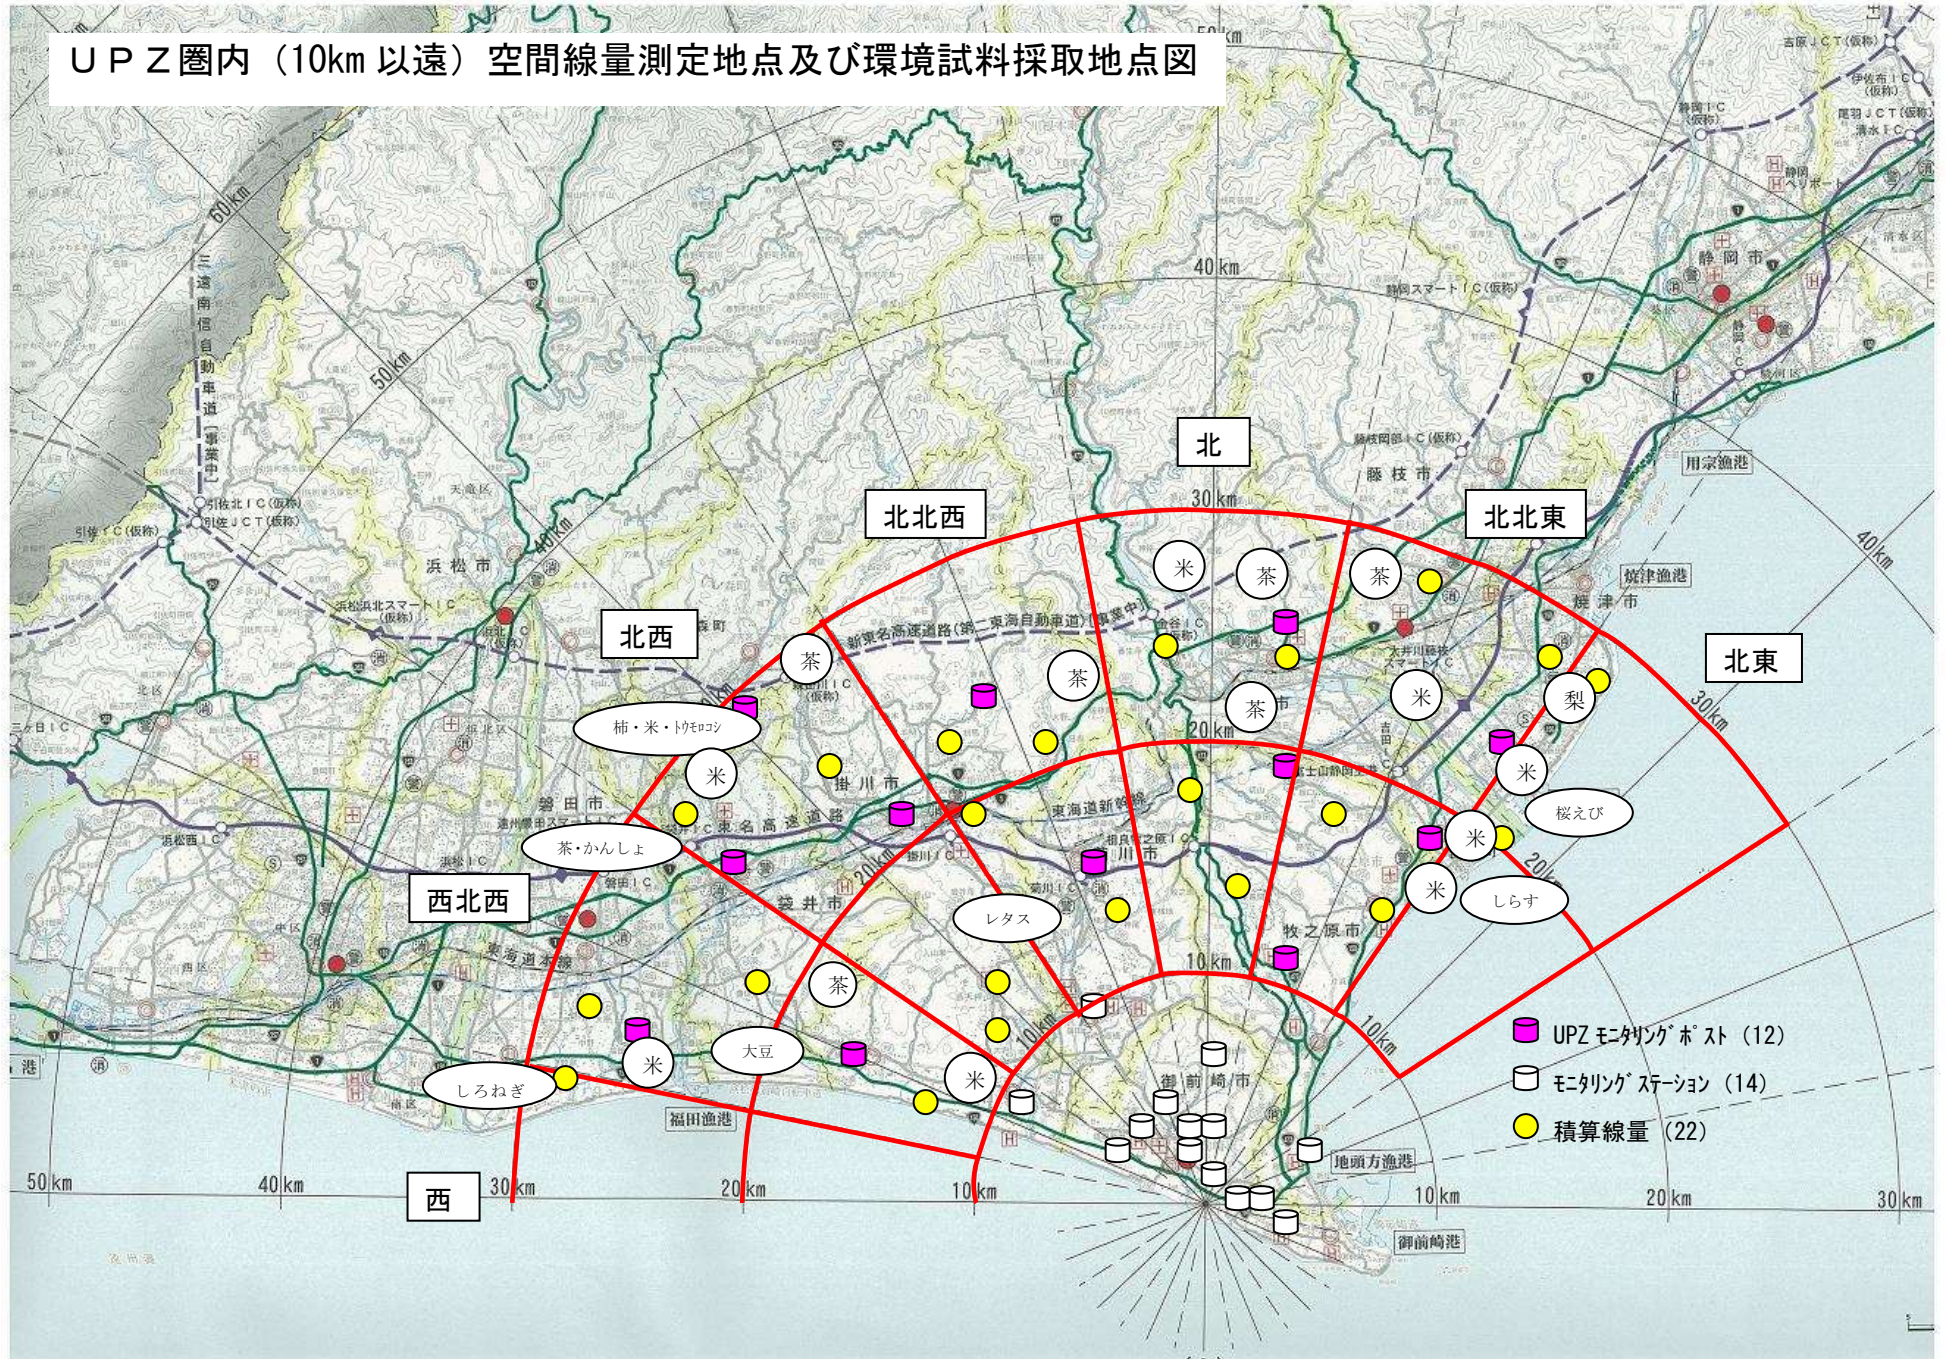

- UPZモニタリングポスト (12)
- モニタリングステーション (14)
- 積算線量 (22)